機械器具(5)麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん
管理医療機器　単回使用麻酔用呼吸回路　37704000

麻酔回路

再使用禁止

【警　告】
- ●他の製品と組み合わせて使用するときは、その接続状態に閉塞等の危険がないか必ず確認すること。[重症事故や死亡事故を招く恐れがあります。]
- ●本品を使用する前に、回路にもれや閉塞がないか、またバッグ等に劣化がないか充分確認すること。
- ●使用中は常に患者の状態を監視し、回路の外れや閉塞等に充分注意すること。

【禁忌･禁止】
- ●本品を火気のある場所で使用しないこと。[爆発や火災の原因となる]
- ●再使用禁止［本品は 1 患者限りの使い捨て製品です。］

【形状･構造等】

●各部の名称

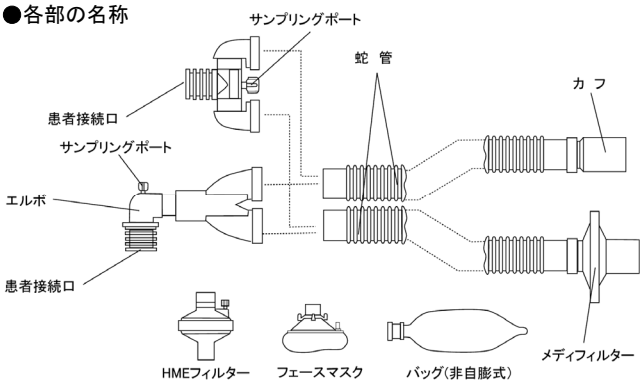

■パラレル Y･ポート付エルボ

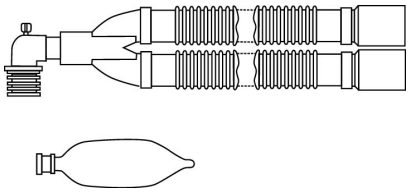

No.	蛇　管	バッグ
149	100cm	2L
1109		3L(ラフコート)
249	150cm	2L
2109		3L(ラフコート)
349	180cm	2L
3109		3L(ラフコート)

●パラレル Y･ポート付エルボ
メディフィルター付

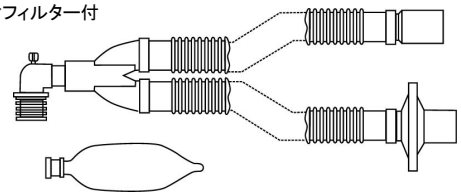

No.	蛇　管	バッグ
149A	100cm	2L
1109A		3L(ラフコート)
249A	150cm	2L
2109A		3L(ラフコート)
349A	180cm	2L
3109A		3L(ラフコート)

●パラレル Y･ポート付エルボ
メディフィルター2 個付

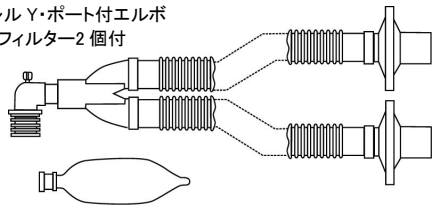

No.	蛇　管	バッグ
149C	100cm	2L
1109C		3L(ラフコート)
249C	150cm	2L
2109C		3L(ラフコート)
349C	180cm	2L
3109C		3L(ラフコート)

●パラレル Y･ポート付エルボ
HME フィルター付

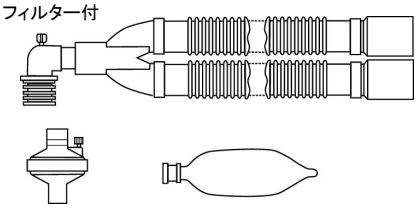

No.	蛇　管	バッグ
149G	100cm	2L
1109G		3L(ラフコート)
249G	150cm	2L
2109G		3L(ラフコート)

●パラレル Y･ポート付エルボ
HME フィルター･成人用マスク付

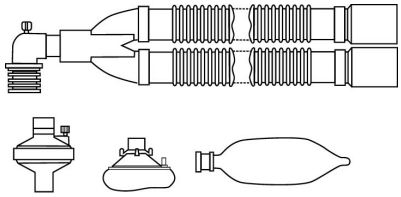

No.	蛇　管	バッグ
149GK	100cm	2L
1109GK		3L(ラフコート)

■ポート付スイーベル Y

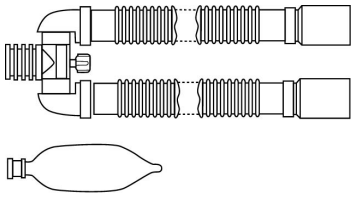

No.	蛇　管	バッグ
1411	100cm	2L
11011		3L(ラフコート)
2411	150cm	2L
21011		3L(ラフコート)
3411	180cm	2L
31011		3L(ラフコート)

●ポート付スイーベル Y
メディフィルター付

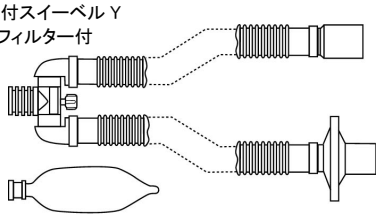

No.	蛇　管	バッグ
1411A	100cm	2L
11011A		3L(ラフコート)
2411A	150cm	2L
21011A		3L(ラフコート)
3411A	180cm	2L
31011A		3L(ラフコート)

●ポート付スイーベル Y
メディフィルター2 個付

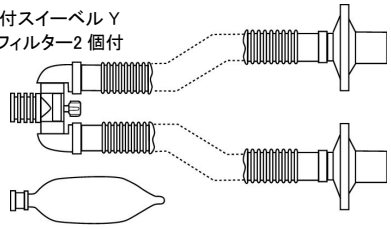

No.	蛇　管	バッグ
1411C	100cm	2L
11011C		3L(ラフコート)
2411C	150cm	2L
21011C		3L(ラフコート)
3411C	180cm	2L
31011C		3L(ラフコート)

●ポート付スイーベル Y
HME フィルター付

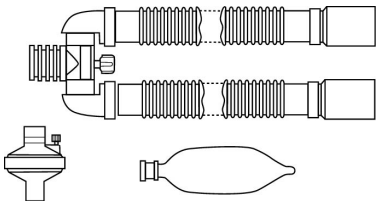

No.	蛇　管	バッグ
1411G	100cm	2L
11011G		3L(ラフコート)
2411G	150cm	2L
21011G		3L(ラフコート)

●ポート付スイーベル Y
HME フィルター・成人用マスク付

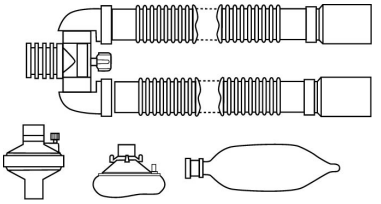

No.	蛇　管	バッグ
1411GK	100cm	2L
11011GK		3L(ラフコート)

●体に接触する部分の組成
ポリ塩化ビニル

【性能・使用目的・効能または効果】

本品は、患者と麻酔器をつなぎ、ガス又は麻酔薬蒸気を通す通路で、中空の回路である。

【操作方法または使用方法等】

1. 使用前の回路試験
(1) 使用する麻酔回路を選択し、回路の各部に破損・亀裂・劣化・汚れ等がないか、また、弛み等がないか確認します。
●麻酔器の始業点検は、各メーカーの取扱説明書に従ってください。

2. 回路の使用方法
(1) 使用する麻酔回路を麻酔器の吸気側、呼気側にそれぞれ接続します。
(2) バッグを麻酔器のバッグ接続口に接続します。
(3) ガスを流して、エルボの患者接続口からガスが出ていることを確認し、閉塞がないことを確認します。
(4) エルボの患者接続口を塞ぎ、ポップオフ弁を閉鎖し、麻酔回路内をガスで充満させ、バッグを手で圧迫して試験し、漏れがないことを確認します。(バッグがしぼんでくるようなら、麻酔回路のどこかに漏れがあると考えられます。)
(5) 麻酔器を病院の標準的な方法に従って準備・設定してください。

3. フェースマスクの使用方法
(1) フェースマスクのバルブに適切なシリンジを接続して、フェースマスクが顔に密着するようにクッションの空気を調節してください。
(2) フェースマスクをエルボの患者接続口に確実に接続します。
(3) フェースマスクを手で持つか、適切なヘッドストラップを後頭部にかけ、フックリングで固定します。

4. HME、HME フィルターの使用方法

(仕　様)
死腔量:85mL
流量抵抗:＞HME:1.0cmH_2O(60L/min) HME フィルター:2.3cmH_2O(60L/min)
加湿性能:28.4mgH_2O／L(1回換気量 500mL)
HME、HME フィルターをエルボの患者接続口に接続し、他端をフェースマスク又は気管内チューブに接続します。
●HME・HME フィルターは患者の口元に使用するものです。麻酔器、人工呼吸器の吸気側、呼気側には使用しないでください。
●気道内の分泌物が付着したりすると、流量抵抗が著しく上昇し危険です。その場合は、すみやかに新しい製品と交換してください。
●ネブライザー、加温加湿器との併用はしないでください。
●HME・HME フィルターを使用する場合は、気道内圧をモニターするとともに、常に直視できるようにしてください。
●HME・HME フィルターは 24 時間までの使用としてください。
●HME・HME フィルターは死腔量を考慮して患者に使用してください。

5. メディフィルターの使用方法
(仕　様)
死腔量:85mL 流量抵抗:＞1.3cmH_2O(60L/min)
回路で使用している蛇管の吸気側端に接続し、他端を麻酔装置の吸気側に接続します。
●患者と機器を感染から適切に守るには、回路の吸気側と呼気側にそれぞれメディフィルターを取り付けることをお勧めします。
●メディフィルターは、ネブライザー、加温加湿器より手前で麻酔器、人工呼吸器の吸気側に接続してください。
●メディフィルターを麻酔器、人工呼吸器の呼気側に使用するときは、ネブライザー、加温加湿器との併用はしないでください。
●メディフィルターを麻酔器、人工呼吸器の呼気側に使用するときは、薬剤、水分等による流量抵抗の上昇には充分注意し、早期に交換してください。
●呼吸回路の蛇管内に結露した水分がメディフィルター内に流れ込まないように注意してください。
●メディフィルターは 24 時間までの使用としてください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意
●本品は、ディスポーザブル製品ですので、一患者の使用で使い捨て、再使用しないでください。
●取り扱いに習熟した者以外は、本品を取り扱わないでください。
●患者の状態を観察しながら慎重に使用してください。
●本品を折り曲げたり、ねじったりしないでください。破損や閉塞のおそれがあります。
●本品に閉塞や漏れが生じた場合は、新しい製品と交換してください。また、製品に悪い影響を及ぼす恐れがありますので、本品を薬液等に浸すことや、ガスや蒸気等での滅菌は行わないでください。
●本品の使用前または使用中に、本品の使用が適切でないと判断した場合は、本品を使用しないか、直ちに使用を中止してください。
●使用後は、医療廃棄物として適切に処理・廃棄してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

●水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
●本品は一回限りの使用になっています。再使用、再滅菌は行わないでください。
●メディフィルター、HME・HME フィルターの使用期間は最長でも 24 時間を超えないようにしてください。

【包　装】

各 1 箱(10 入)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社
〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1
TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)

■外国製造所

国　　名:USA(アメリカ合衆国)
製造業者:Unomedical, Inc.(ウノメディカル社)